

テクニカル ノート

松崎 五

松下 駿

石田 健 幸

木原 啓 一  
生 重 哲 男

崎 山 和 孝

Laboratory Automation System I





Gas Chromatograph Online Syst

DECISION OF MAKER SYSTEM

PROVISIONAL CONTRACT

FOUNDATION OF COMMITTEE

48年3月1日 前原へ夕外土港へ 送る

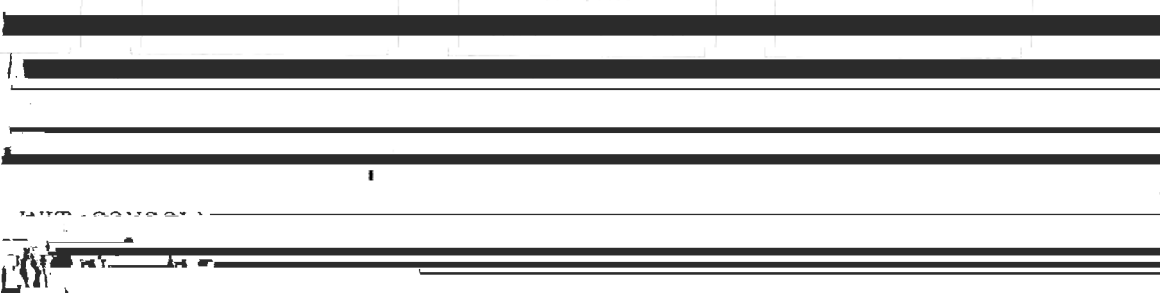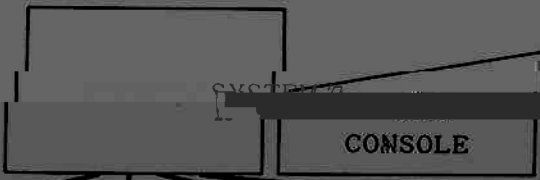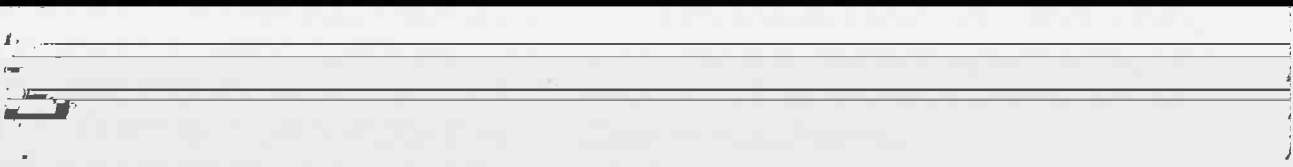
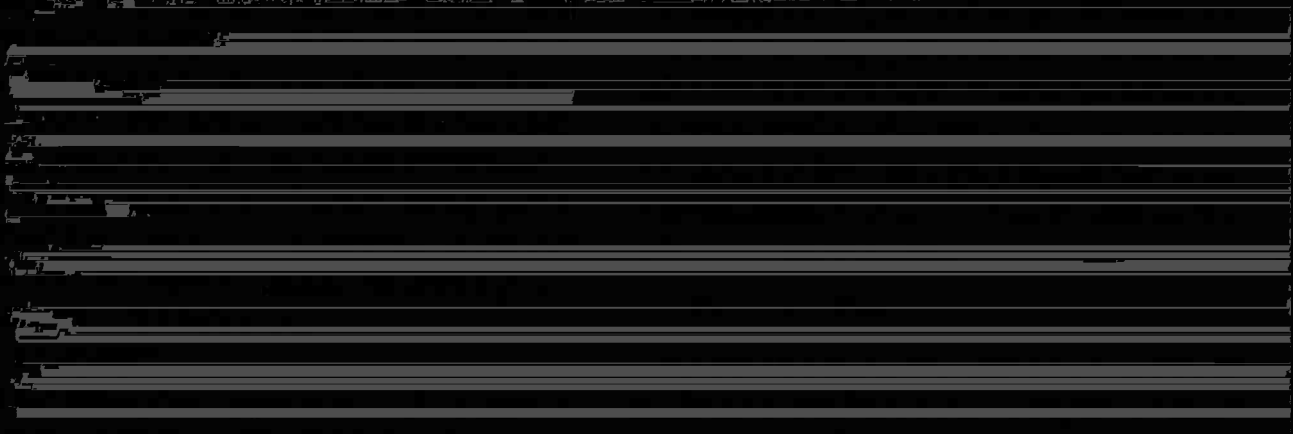


本システムは生データを集めたもので、検査の結果は、

[Redacted text block]



[Redacted text block]

[Redacted text block]

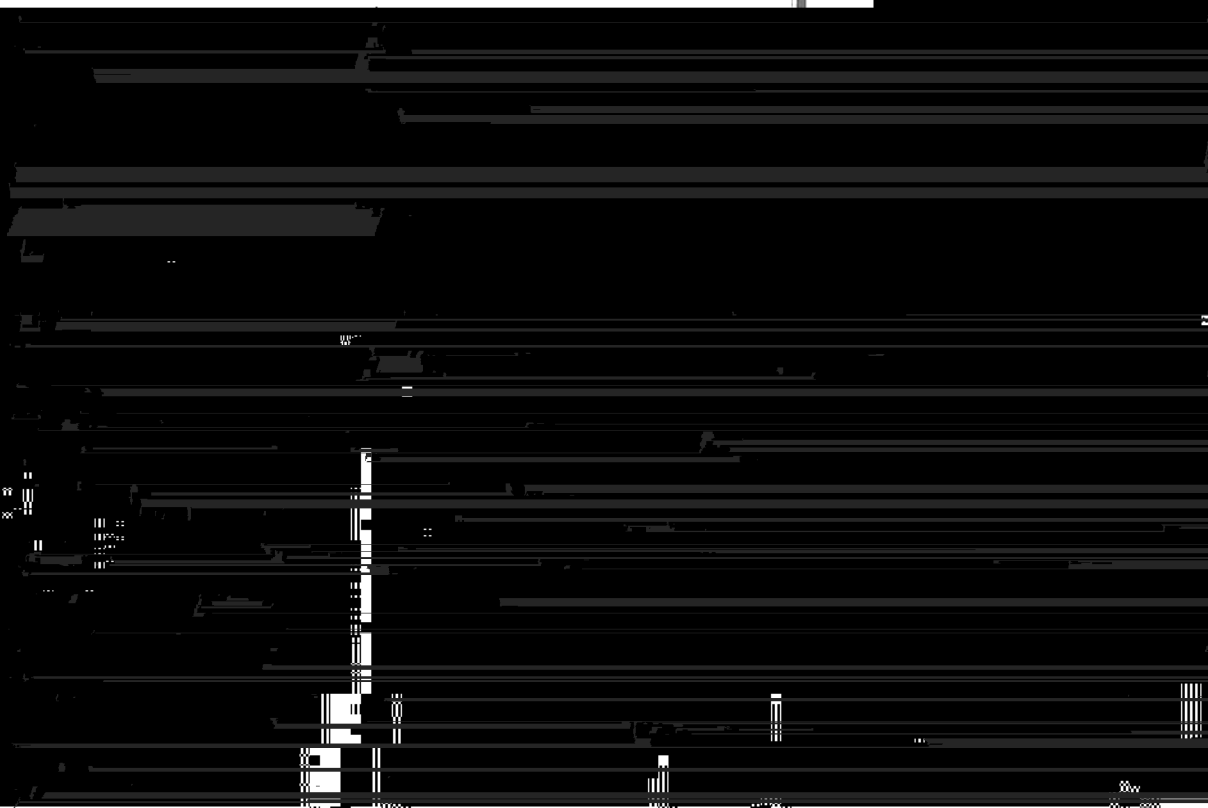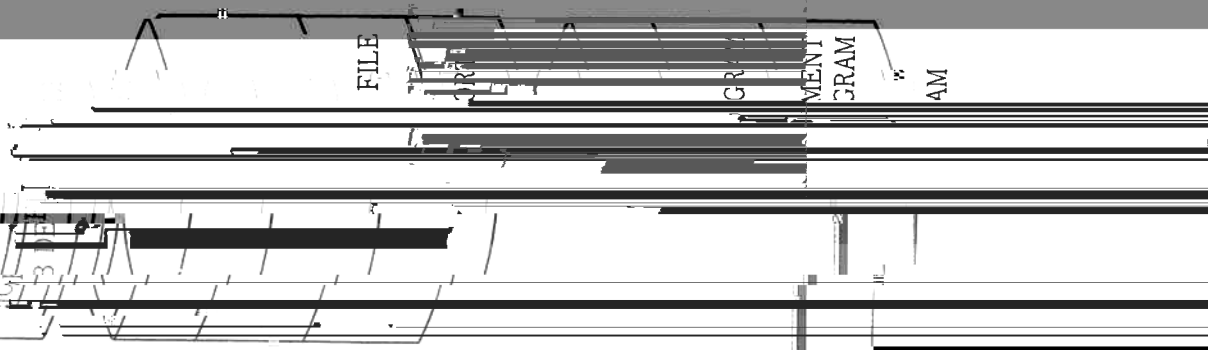

東京市立大学

システム分析


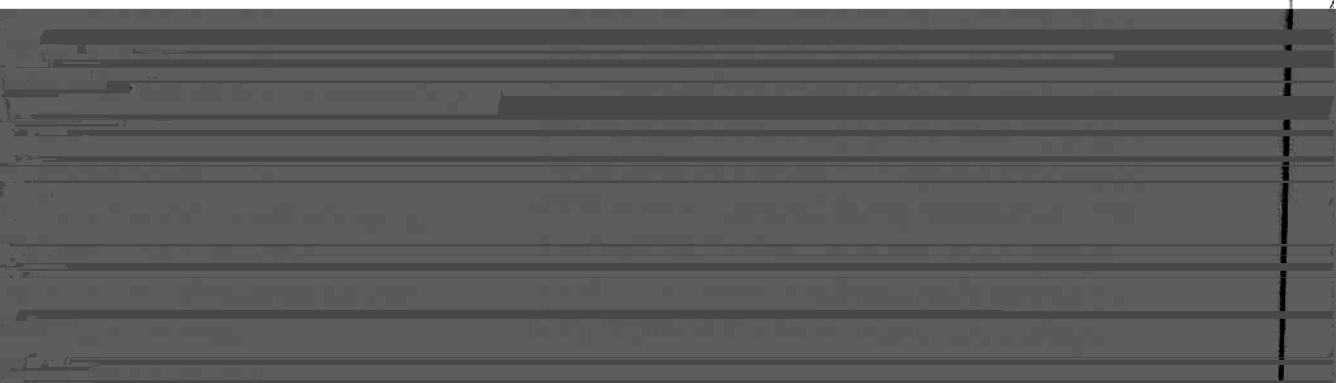
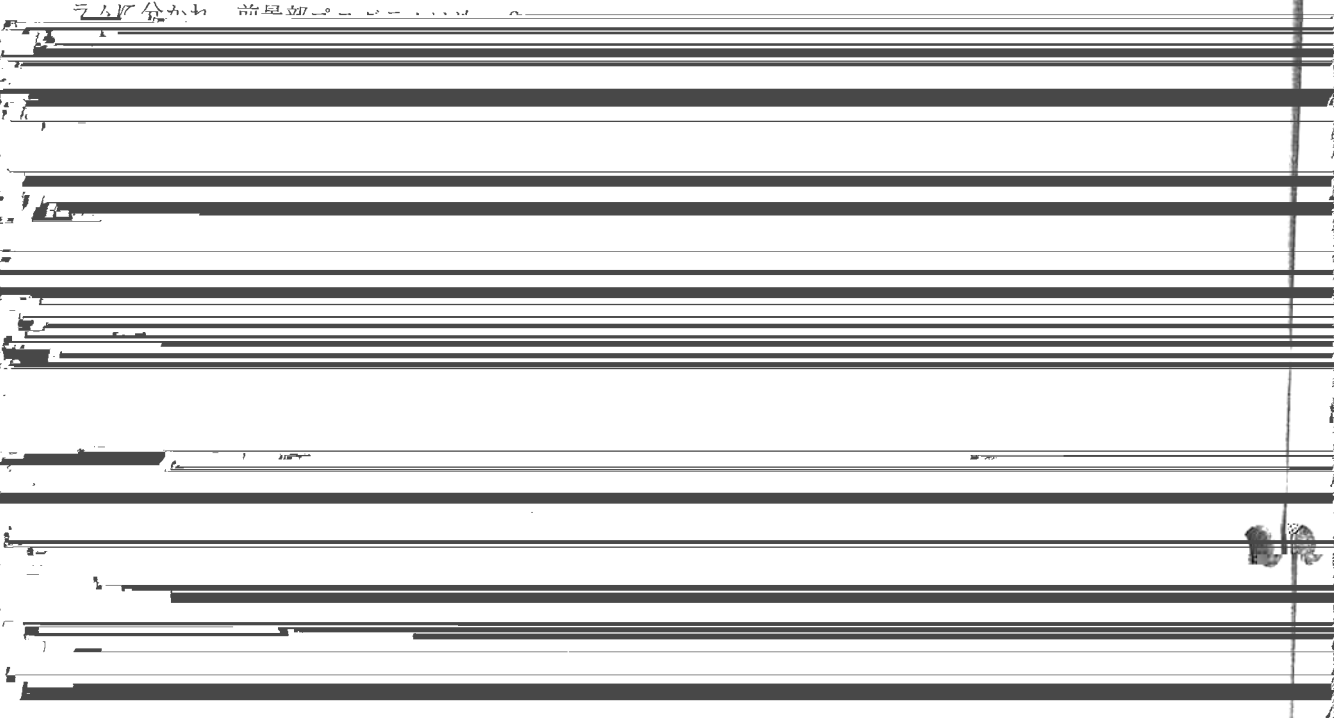



1) システムの初期化



INITIATION

INITIATION

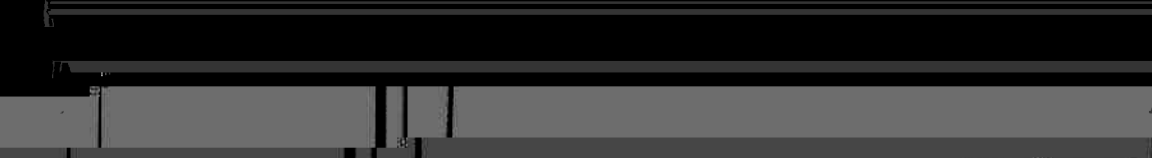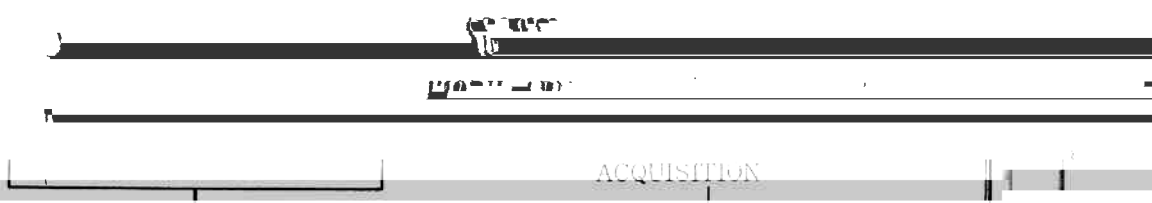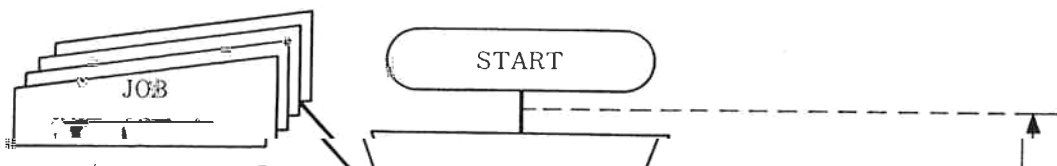

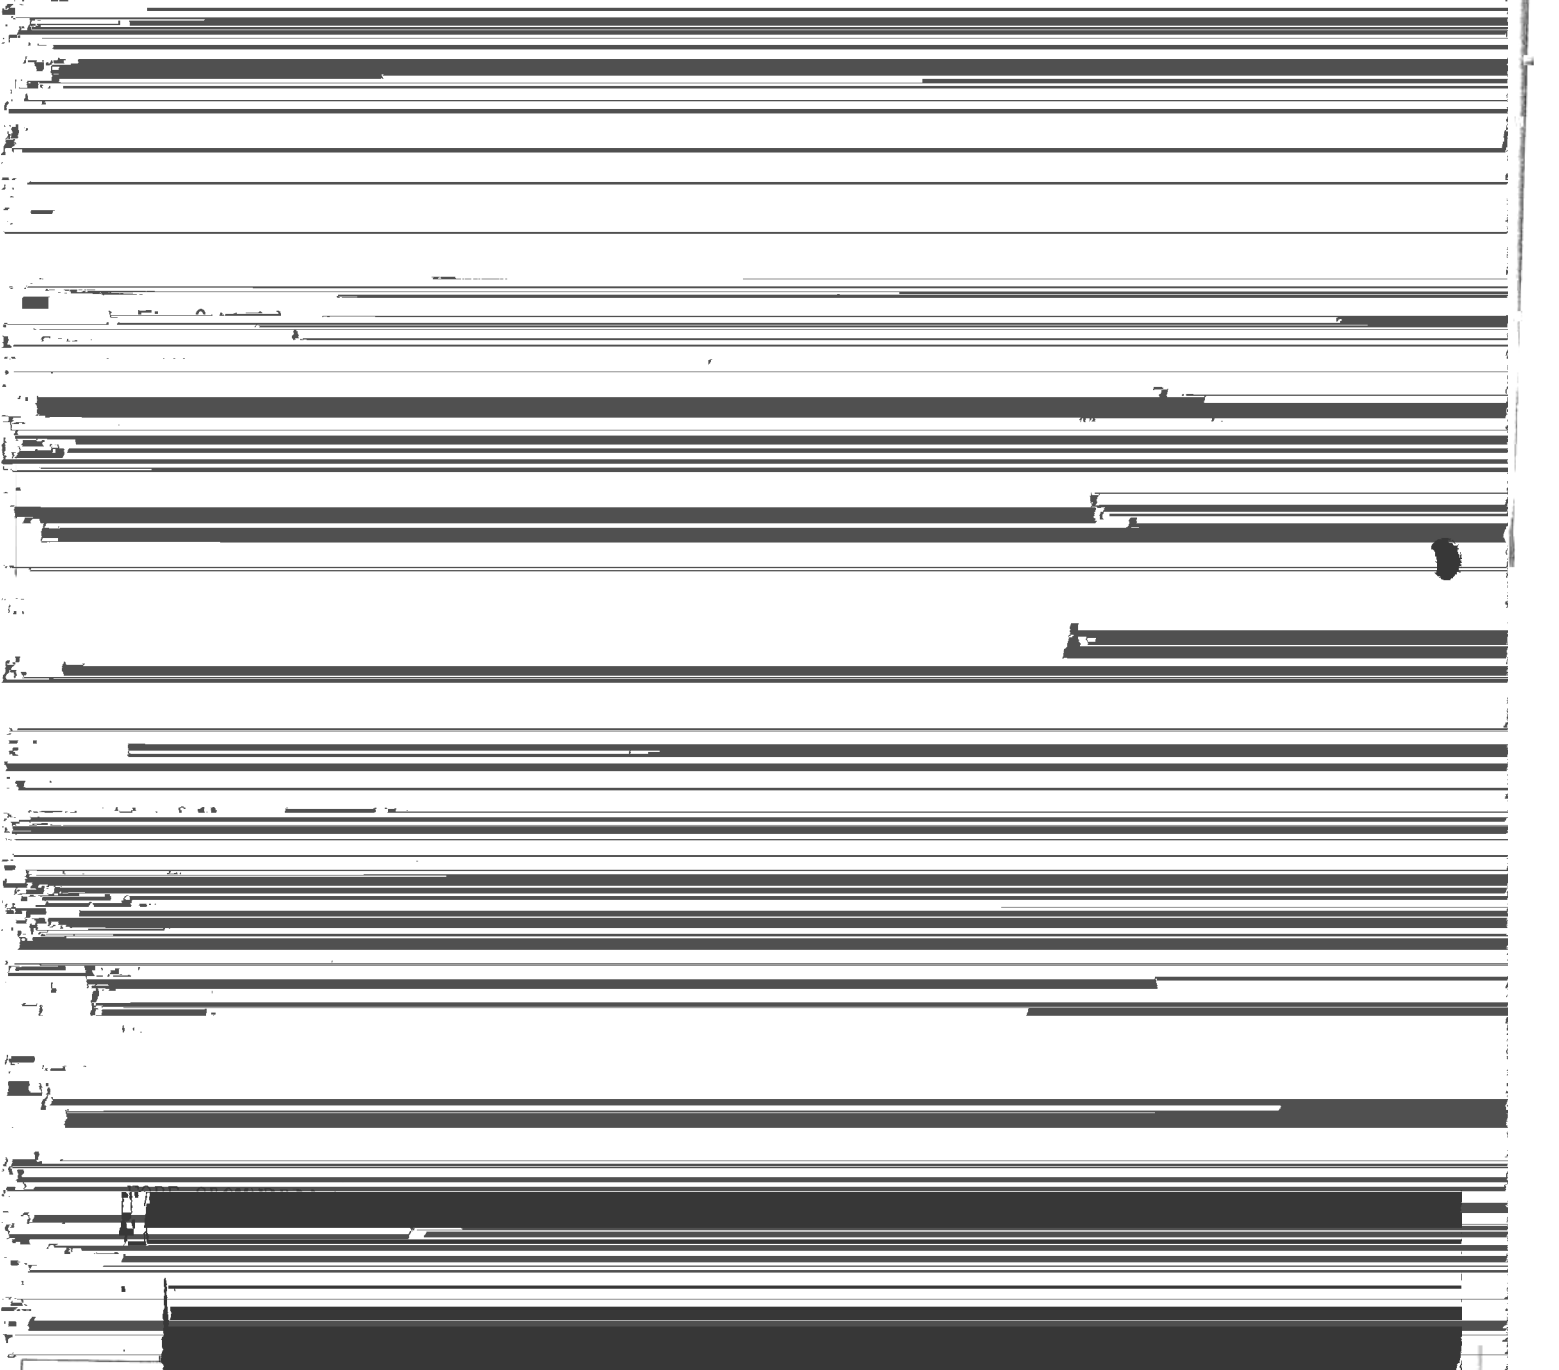

GAIN COORDINATION

ERROR MESSAGE

PRINT OUT

RAW DATA



Table 2 Internal standard method

		AREA (MV-SEC)
STANDARD		4518.8726
PEAK 2	39.5139	10.3178

